
01 설치와 기본 조작


설치 후 단말의 버튼과 화면 구성을 먼저 확인하세요.

1. 설치

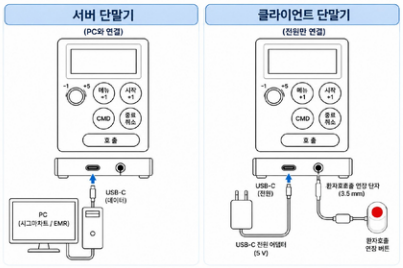

서버 단말기: PC와 USB-C 데이터 케이블로 연결하고 SigmaCall Agent를 설치합니다.
클라이언트 단말기: 각 치료실 베드에 설치하고 USB-C 전원을 연결합니다. 필요 시 환자호출 연장 버튼을 연결합니다.


2. 버튼 기능

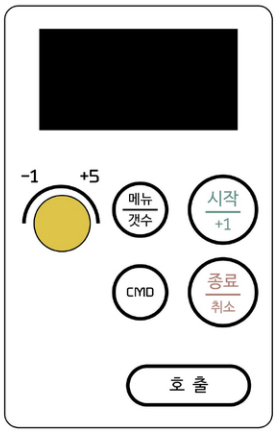

- 다이얼 회전: 치료 종류 선택
- 치료 중 좌회전 −1분 / 우회전 +5분
- 다이얼 클릭: 메시지 확인 / 종료
- 시작: 치료 시작, 치료 중 +1분
- 종료: 치료 종료 / 환자호출 해제
- CMD: 치료요청 및 해제
- 메뉴/개수: 설정 또는 침 개수 입력

3. 화면 구성

현재 치료 상태를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

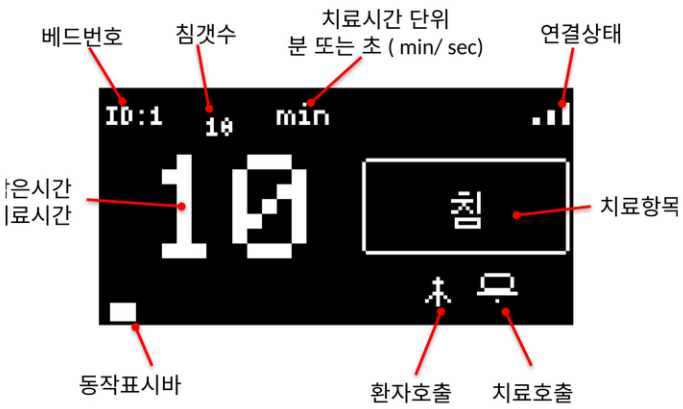

베드번호, 치료항목, 남은시간, 치료시간 단위와 연결상태를 표시합니다.

환자호출·치료호출 등 현재 상태는 화면의 상태 아이콘으로 확인할 수 있습니다.

02 치료 사용 방법


치료 시작부터 시간 변경, 메시지와 호출까지 기본 조작을 정리했습니다.

4. 치료 시작 / 종료



다이얼로 치료 종류를 선택한 뒤 시작 버튼을 누릅니다. 치료를 끝낼 때는 종료 버튼을 눌러 대기 화면으로 돌아갑니다.

5. 치료시간 변경

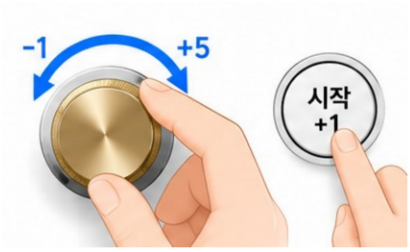

치료 중 다이얼 오른쪽은 +5분, 왼쪽은 −1분입니다. 시작 버튼을 한 번 누르면 +1분이 추가됩니다.


6. 메시지 보기



다이얼 누르기 (클릭)

다이얼을 클릭하면 현재 베드의 메시지를 조회합니다. 메시지 표시 중 다시 클릭하면 바로 기본 화면으로 돌아갑니다.

7. 호출 기능

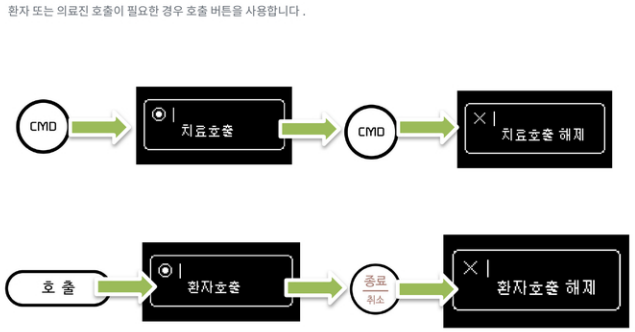


호출 버튼은 환자호출, CMD는 치료요청입니다. 환자호출은 종료 버튼으로, 치료요청은 CMD를 다시 눌러 해제합니다.

03 침 개수와 SigmaCall Agent

침 개수 입력과 PC Agent의 기본 설정 방법입니다.

8. 침 개수 입력

침 치료 등 정량정보가 필요한 치료에서 사용 개수를 입력합니다 .

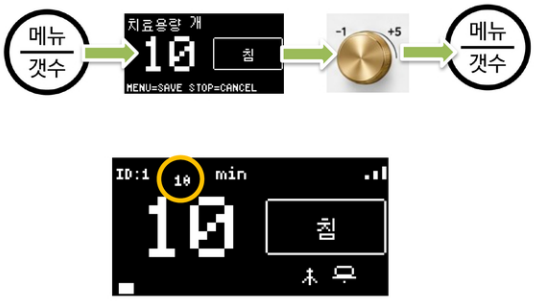


사용 방법

침 치료를 선택한 상태에서 메뉴/개수 버튼으로 입력 화면을 엽니다. 다이얼로 1개 단위로 조절하고 메뉴 버튼을 다시 눌러 저장합니다.
치료 중에는 침 개수가 화면 상단에 표시되며, 치료 종료 시에도 종료 화면과 함께 확인할 수 있습니다.

9. SigmaCall Agent 설정

PC 의 SigmaCall Agent 에서 단말 연결과 운영 상태를 확인합니다 .

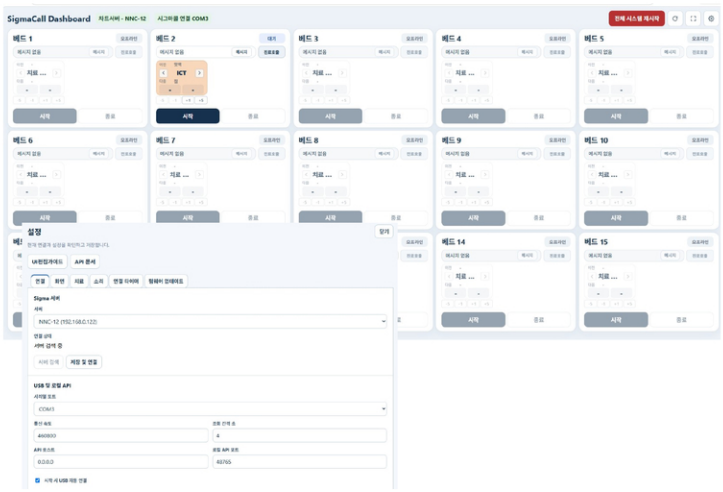

사용 방법

서버 단말기가 연결된 PC에 SigmaCall Agent를 설치합니다. 설치 후 PC 시작 시 자동 실행되며 기본적으로 작업표시줄 우측 트레이에서 동작합니다.
트레이 아이콘을 더블클릭하면 상태창을 열 수 있습니다. 최초 실행 시 설정 메뉴에서 COM 포트 연결, 서버 연결 및 포트 설정을 확인합니다.